



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

CHARISMA ONE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
"ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ"

Τι θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας
πριν αναρτήσετε το δικό σας κλινικό
περιστατικό με την απόχρωση ONE

ONE

**EXPERIENCED
SOLUTION**





KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Προϋποθέσεις για την υποβολή κλινικού περιστατικού:

- Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες απεικονίζουν τη χρήση των υλικών **Charisma Diamond / Charisma Toraz ONE**.
- Επιλέξτε **απλές, καθημερινές αποκαταστάσεις** (κατά προτίμηση περιστατικά οπισθίων αποκαταστάσεων - **κατηγορίας I & II**) οι οποίες συνήθως δεν εξατομικεύονται με ξεχωριστές χρωματικές αποχρώσεις (staining).
- Σε περίπτωση που εμφανίζεται ολόκληρη η διαδικασία αποκατάστασης, λάβετε υπόψη τα εξής βήματα: αρχική κατάσταση, τρόχισμα, προετοιμασία, εφαρμογή συγκολλητικού παράγοντα (GLUMA Bond Universal), τοποθέτηση απόχρωσης Charisma ONE, φινίρισμα & γυάλισμα (Charisma EasyShine) και, εάν είναι δυνατόν, μετά την επανυδάτωση.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση απομονωτήρα.

Προϋποθέσεις φωτογραφικού υλικού:

- Μια **ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR** με ring ή πλευρικό φλας θα πρέπει να χρησιμοποιείται **σε συνδυασμό με φακό τύπου macro**.
- Τραβήξτε φωτογραφίες σε μορφή αρχείου **RAW- , TIF ή υψηλής ποιότητας JPEG**.
- Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι **ευκρινείς με μεγάλο βάθος πεδίου (μεγάλη τιμή διαφράγματος)**.
- Χρησιμοποιήστε πάντα τις ίδιες λεπτομέρειες φωτογραφίας (και διατηρείτε το πλαίσιο κοινό) σε μια σειρά φωτογραφιών.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση **καθαρό φωτοκαθρέφτη χωρίς θάμπωμα** για φωτογραφίες μασητικών/παρειικών πλευρών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χείλη και η γλώσσα έχουν απομακρυνθεί επαρκώς και ότι η **κλινική κατάσταση είναι καθαρή και στεγνή**.
- Εάν τραβάτε φωτογραφίες ολόκληρου προσώπου που κάνουν τον ασθενή αναγνωρίσιμο, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς (παρακαλούμε να την κρατήσετε μαζί με τα αρχεία σας).

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ & ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (Π.Χ. ΧΡΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ)
- ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ Η ΑΠΟΧΡΩΣΗ ONE
- ΚΑΛΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I ΚΑΙ II)
- ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΙ ΜΑΣΗΤΙΚΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
- ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ. Η ΑΝΤΟΧΗ ΑΥΤΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ TCD
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CHARISMA EASYSHINE
- ΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GLUMA BOND UNIVERSAL
- ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KULZER ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ!)



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP




'Πριν & Μετά' φωτογραφίες - παραδείγματα:




Δρ. Dominik Slusarczyk
Κατοβίτσε, Πολωνία

Αντικατάσταση ανεπαρκούς
υαλοϊονομερούς αποκατάστασης
χρησιμοποιώντας Charisma Diamond
ONE

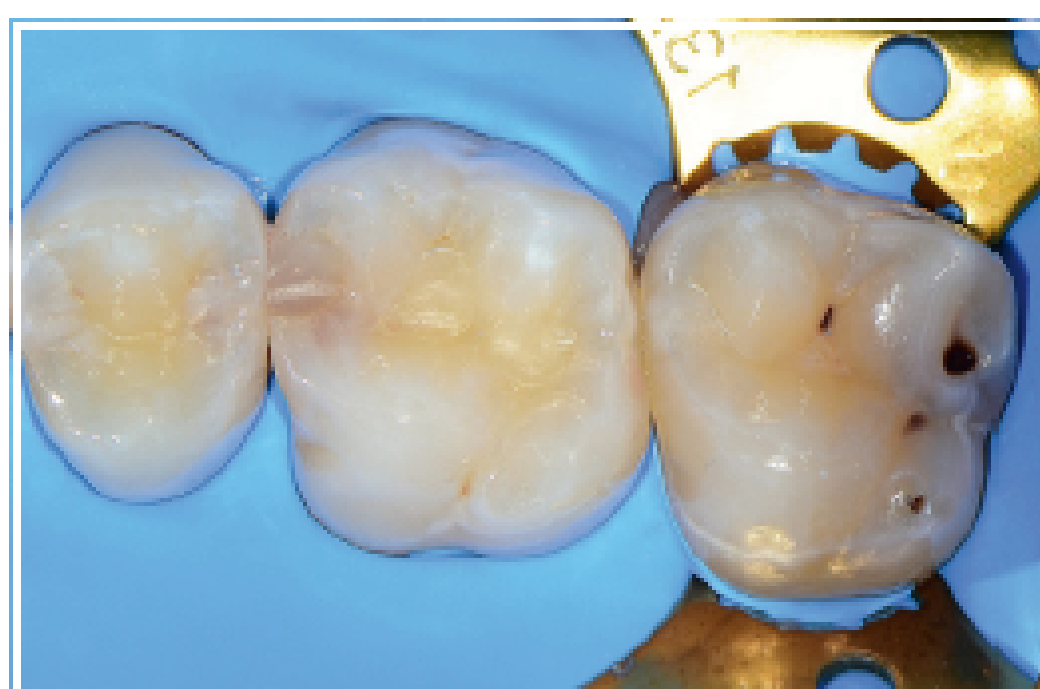

Δρ. Ubiracy Gaiao
Παρανά, Βραζιλία

Αποκατάσταση τεταρτημορίου με την
χρήση της Charisma Diamond ONE

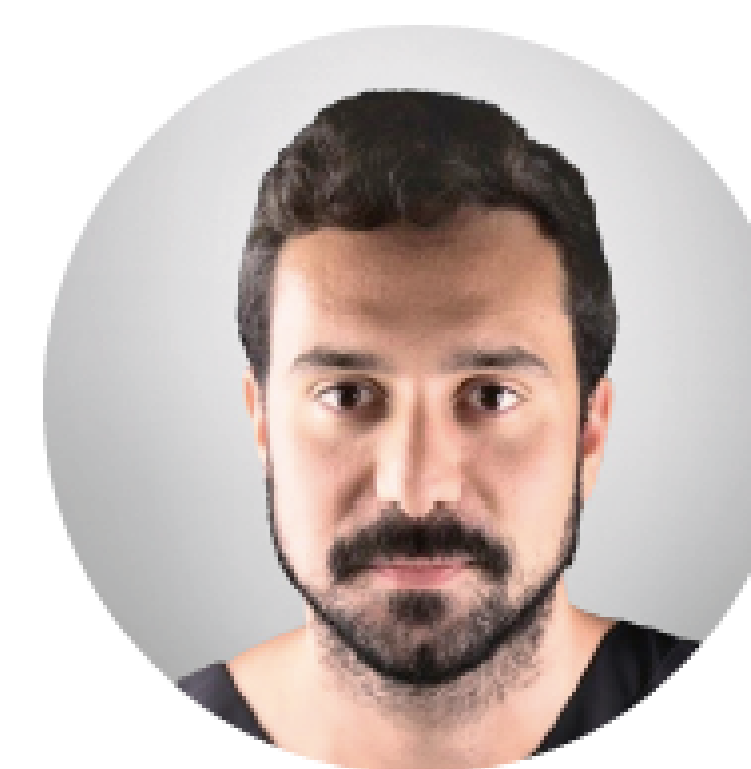

Δρ. Ανδρέας Σπαβέρας
Αθήνα, Ελλάδα

Ανακατασκευή εκτενών κοιλοτήτων με
την Charisma Diamond ONE

